



**Клапан быстроразъемный  
(система клапанная быстроразъемная)  
СКБ-1**

**ПАСПОРТ  
ДЖЕТ 396 00 00 00 ПС**



### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Клапан быстроразъемный (система клапанная быстроразъемная) СКБ-1 предназначен для монтажа в газовые магистрали низкого давления 0,6 МПа (6,0 кгс/см<sup>2</sup>) не более и служит для оперативного подключения пневмооборудования к источнику нужного газа. СКБ-1 может быть установлен в магистрали следующих газов: кислород, углекислый газ, закись азота, воздух, вакуум. СКБ-1 и его комплектующие имеют цветовую маркировку и механическую кодировку (см. Раздел 4 Паспорта «Устройство и принцип работы») в зависимости от вида газа в магистрали, в которую предполагается монтаж СКБ-1.

Применяемую среду (газ в магистрали) потребитель указывает в заказе.

1.2 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15050 для работы в интервале температур окружающей среды от плюс 10° до плюс 35°С и относительной влажностью 30-80%

1.3 Система клапанная быстроразъемная СКБ-1 ДЖЕТ 396 00 00 00 двухместная, состоит из девяти сборочных единиц:

- штекер газовый ШГ  ДЖЕТ 666 11 00 00 – 3 шт.;
- клапан газовый КГ  ДЖЕТ 294 02 00 00, ДЖЕТ 396 02 00 00,  
ДЖЕТ 396 03 00 00;
- коробка монтажная КМ  ДЖЕТ 394 01 00 00.

1.4. Пример условного обозначения системы клапанной быстроразъемной СКБ-1 см. табл.2:

«ДЖЕТ 396 00 00 00-012 - СКБ-1 на 3 газа: кислород, углекислый газ и закись азота

«ДЖЕТ 396 00 00 00 -123 - СКБ-1 на 3 газа: углекислый газ, закись азота и воздух.

Пример условного обозначения комплектующих к СКБ-1 при заказе см. табл.2: «ДЖЕТ 666 11 00 00 Штекер газовый ШГ на кислород»

«ДЖЕТ 355 02 00 00-02 Клапан газовый КГ-1 на закись азота»

«ДЖЕТ 394 01 00 00 Коробка монтажная на три клапана»

Сокращения, применяемые в таблицах и далее по тексту:

- O2 - кислород;
- CO2 – углекислый газ;
- N2O – закись азота;
- AIR – сжатый воздух;
- ВАК - вакуум;
- ШГ – штекер газовый»
- КГ-1, КГ-2, КГ-3 – клапан газовый
- КМ – коробка монтажная.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики см. табл. 1.

Таблица 1

Диаметр номинального прохода DN, мм	3,5; 5,9
Давление номинальное PN, МПа, кроме клапана на вакуум	от 0,2 до 0,6
Давление номинальное PN, МПа, для клапана на вакуум	от 0 до минус 0,08
Класс герметичности по ГОСТ 9544	B <sub>1</sub>
Наибольший расход газ, л/мин., не менее, кроме клапана на вакуум	40
Наибольший расход газ, л/мин., не менее, для клапана на вакуум	10
Наружный диаметр трубки подвода газа, мм	8
Габаритные размеры, ВxLxH, мм	95x250x128
Масса не более, кг	2,4

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект СКБ-1 входят:


- |   |       |
|---|-------|
| 1. Штекер газовый ШГ ДЖЕТ 666 11 00 00    | 3 шт. |
| 2. Клапан газовый КГ-1 ДЖЕТ 294 02 00 00  | 1 шт. |
| 3. Клапан газовый КГ-2 ДЖЕТ 396 02 00 00  | 1 шт. |
| 4. Клапан газовый КГ-3 ДЖЕТ 396 03 00 00  | 1 шт. |
| 5. Коробка монтажная КМ ДЖЕТ 394 01 00 00 | 1 шт. |
| 6. Паспорт ДЖЕТ 396 00 00 00 ПС           | 1 шт. |

Примечание: По требованию заказчика комплектующие сборочные единицы СКБ-1 могут поставляться отдельно см. табл.2.

Таблица 2

Обозначение по КД	Наименование	Рабочая среда (вид газа)	Цвет шильдиков
ДЖЕТ 396 00 00 00 -012	СКБ-1	O <sub>2</sub> -CO <sub>2</sub> -N <sub>2</sub> O	Синий-чёрный-зелёный
ДЖЕТ 396 00 00 00 -013		O <sub>2</sub> -CO <sub>2</sub> -AIR	Синий-чёрный-жёлтый
ДЖЕТ 396 00 00 00 -014		O <sub>2</sub> -CO <sub>2</sub> -VAK	Синий-чёрный-красный
ДЖЕТ 396 00 00 00 -023		O <sub>2</sub> -N <sub>2</sub> O-AIR	Синий-зелёный-жёлтый
ДЖЕТ 396 00 00 00 -024		O <sub>2</sub> -N <sub>2</sub> O-VAK	Синий-зелёный-красный
ДЖЕТ 396 00 00 00 -034		O <sub>2</sub> -AIR-VAK	Синий-жёлтый-красный
ДЖЕТ 396 00 00 00 -123		CO <sub>2</sub> - N <sub>2</sub> O-AIR	Чёрный-зелёный-желтый
ДЖЕТ 396 00 00 00 -124		CO <sub>2</sub> -N <sub>2</sub> O-VAK	Чёрный-зелёный-красный
ДЖЕТ 396 00 00 00 -234		N <sub>2</sub> O-AIR-VAK	Зелёный-жёлтый-красный
ДЖЕТ 666 11 00 00		Штекер газовый ШГ	O <sub>2</sub>
ДЖЕТ 666 11 00 00 -01	CO <sub>2</sub>		черный
ДЖЕТ 666 11 00 00 -02	N <sub>2</sub> O		зеленый
ДЖЕТ 666 11 00 00 -03	AIR		желтый
ДЖЕТ 666 11 00 00 -04	VAK		красный
ДЖЕТ 294 02 00 00	Клапан газовый КГ-1	O <sub>2</sub>	синий
ДЖЕТ 294 02 00 00-01		CO <sub>2</sub>	черный
ДЖЕТ 294 02 00 00-02		N <sub>2</sub> O	зеленый
ДЖЕТ 294 02 00 00-03		AIR	желтый
ДЖЕТ 294 02 00 00-04		VAK	красный
ДЖЕТ 396 02 00 00	Клапан газовый КГ-2	O <sub>2</sub>	синий
ДЖЕТ 396 02 00 00 -01		CO <sub>2</sub>	черный
ДЖЕТ 396 02 00 00 -02		N <sub>2</sub> O	зеленый
ДЖЕТ 396 02 00 00 -03		AIR	желтый
ДЖЕТ 396 02 00 00 -04		VAK	красный
ДЖЕТ 396 03 00 00	Клапан газовый КГ-3	O <sub>2</sub>	синий
ДЖЕТ 396 03 00 00 -01		CO <sub>2</sub>	черный
ДЖЕТ 396 03 00 00 -02		N <sub>2</sub> O	зеленый
ДЖЕТ 396 03 00 00 -03		AIR	желтый
ДЖЕТ 396 03 00 00 -04		VAK	красный
ДЖЕТ 394 01 00 00	Коробка монтажная КМ		белый

## 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

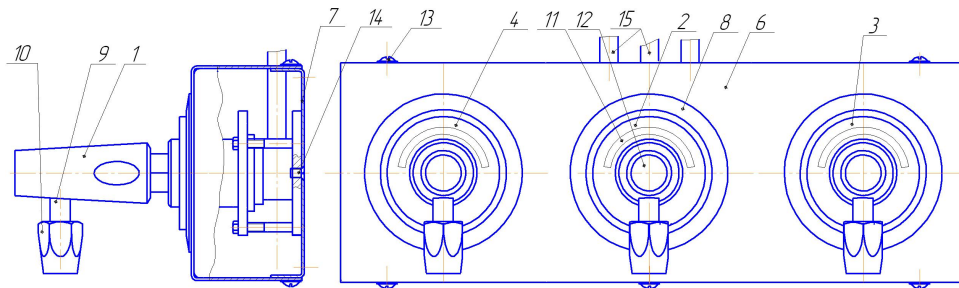


**Рис.1 СКБ-1 ДЖЕТ 396 00 00 00**

1-штекер газовый; 2,3,4 - клапан газовый (КГ-1,КГ-2,КГ-3); 6-крышка коробки; 7-основание коробки; 8-кольцо коробки; 9-штуцер выходной; 10-гайка зажимная; 11-шильдик клапана; 12-шильдик штекера; 13-винт крепления крышки; 14-винты крепления клапанов; 15-трубки подвода газов.

4.1 СКБ-1 в сборе (см. рис.1) состоит из трех штекеров газовых 1, трех клапанов газовых 2,3,4, коробки монтажной, состоящей из крышки 6 и основания 7

4.2 Варианты геометрической формы гнезда клапана газового и штекера газового по стандарту DIN13260-2 (механическая кодировка) в зависимости от рабочей среды см. табл.3

На рис.2 показаны стыковочные размеры штекеров и соответствующего гнезда клапанов.

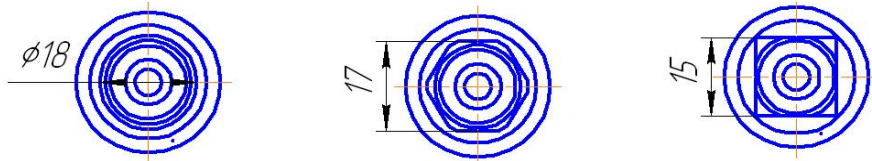

**Рис.2 Геометрические формы гнезд клапанов и штекеров (механическая кодировка)**

Таблица 3

Рабочая среда	Варианты исполнения	Размеры гнезда клапана	Присоединительные размеры штекера
O <sub>2</sub>	шестигранник	S17	Ø 13,8; S17
CO <sub>2</sub>	шестигранник	S17	Ø 11,8; S17
N <sub>2</sub> O	круглый	Ø18	Ø 11,8; Ø18
AIR	квадрат	□15	Ø 13,8; □15
VAK	квадрат	□15	Ø 11,8; □15

4.3 СКБ-1 крепится в любом удобном для подачи рабочей среды месте.

4.4 Рабочая среда поступает по магистрали, отвод которой присоединен к входным трубкам 15 клапанов газовых 2,3,4 и далее через клапаны поступает во входные штуцера соответствующих штекеров газовых 1. Пройдя через отверстие штекера газового и далее через выходной штуцер 9 к газовому оборудованию. На выходной штуцер 9 надевается трубка на основе пластифицированного поливинилхлорида и обжимается гайкой 10.

4.5 Принцип работы СКБ-1 основан на быстром, надежном подключении/отключении рабочей среды к источнику/от источника потребления.

Штекер газовый при установке в клапан имеет два положения:

- установка до первого щелчка замка соединения - «парковочное» положение;
- установка до второго щелчка (до упора)– «рабочее» положение.

При установке в первое положение штекер газовый фиксируется в клапане, но подачи газа нет. При установке во второе положение штекера газового открывает клапан, что обеспечивает подачу газа к потребителю.

4.6 Для выключения СКБ-1 необходимо нажать до упора на соответствующую планку запорную 8 (см. рис.1) и вынуть штекер газовый 1 из клапана газового.

## 5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Для установки СКБ-1 см. рис.1 необходимо:

- вскрыть упаковку с СКБ-1;
- отвернуть 5 винтов 13, снять крышку 6 КМ;
- разметить место крепления СКБ-1 по отверстиям Ø5,5 на дне корпуса 7 КМ;
- закрепить корпус 7 с закрепленными газовыми клапанами 2,3,4 (метод крепления на усмотрение заказчика);
- подсоединить магистраль к входной трубке КГ, подать газ и убедиться в отсутствии утечки газа в местах соединения магистрали и КГ;
- установить крышку 6 КМ на место;
- установить ШГ в рабочее положение и убедиться в поступлении газа до потребителя.

Система готова к эксплуатации.

5.2 ШГ из посадочного гнезда КГ устанавливать и освобождать усилием руки. Вход и выход ШГ должен быть без заеданий. Не допускается приложение чрезмерных усилий

5.3 В процессе эксплуатации СКБ-1 не допускается воздействия на него механических нагрузок, приводящих к повреждению деталей ШГ и КГ.

5.4 ШГ, КГ имеет шильдики 11и12, цвет которых соответствует газу.

5.5 ШГ и посадочное гнездо КГ каждого комплекта имеют геометрические размеры (механическая кодировка) соответствующие определенному виду газа (См. Рис.2 и табл.3).

## 6 ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Общие требования по безопасности при монтаже, эксплуатации и утилизации по ГОСТ Р 53672.

6.2 Не допускается попадание смазочных материалов вовремя монтажа СКБ-1 во внутреннее отверстие клапана газового для кислорода и на штуцер штекера газового для кислорода.

6.3. **Запрещается установка СКБ-1 на участках магистралей с давлением рабочей среды большим, чем 0,6 МПа (6,0 кгс/см<sup>2</sup>).**

6.4 **Запрещается применять СКБ-1 для закиси азота в присутствии аммиака и его растворов, окиси углерода (угарного газа) в любых концентрациях.**

**Категорически запрещается применение любого комплектующего СКБ-1 на не соответствующий газ!**

## 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Условия транспортирования СКБ-1 по группе 3 (ЖЗ) ГОСТ 15150

7.2 Условия хранения СКБ-1 по группе 1 ГОСТ 15150 (сухие, отапливаемые помещения). Хранение должно осуществляться на складе в упаковке изготовителя. Срок хранения – 1 год

7.3 СКБ-1 выработавшие срок службы и непригодные к восстановлению опасности для жизни, здоровью людей и окружающей среды не представляют и подлежат к сдаче в металлолом.

## 8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта о несоответствии произвольной формы. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается.

8.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.

8.3 *При использовании товара не по назначению, а также с нарушениями требований эксплуатационной документации, внесении каких-либо изменений без согласования с предприятием-изготовителем, производитель рекламаций не принимает и претензии не рассматривает.*

## 9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

9.1 СКБ -1 ДЖЕТ 396 00 00 00 - \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ изготовлена, обезжирена и испытана согласно конструкторской документации, соответствует требованиям ТУ 3712-021-54455145-2011, и признана годной для эксплуатации.

9.2 Отметка о приёмке: \_\_\_\_\_

9.3 Дата выпуска: \_\_\_\_\_

## 10 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ

10.1 Назначенный ресурс изделия - 3000 часов

10.2 Назначенный срок службы – 4 года.

10.3 Указанные ресурсы, сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

## 11 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 3712-021-54455145-2011 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

11.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи.

## 12 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.13697/21

Срок действия по 27.09.2026 включительно.

**Изготовитель: ООО «СваркаДжет»**

426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: jet@svarkajet.ru

<http://www.promjet.ru>